

2021年10月25日

診療科長 医局長  
 病棟医長 外来医長  
 中央診療施設副部長 殿  
 看護部長 看護師長  
 事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報No. 39

外注項目検査内容変更のお知らせ

外注業者より、下記項目におきまして試薬変更に伴い、測定原理と基準値変更の連絡がありましたのでご案内いたします。

記

変更項目：サイトメガロウイルス IgG  
 サイトメガロウイルス IgM

旧

測定原理	基準値	
	EIA	IgG (単位なし)
2.0 未満		0.80 未満



新


測定原理	判定		
	CLIA	IgG (AU/mL)	IgM (Index)
6.0 未満		0.85 未満	陰性
<del>6.0 未満</del>		0.85~1.00 未満 ※2	判定保留
	6.0 以上 ※1	1.00 以上	陽性

※1 6.0~15.0 AU/mL の結果値の際には、適切な期間（例：2 週間）内に再採取し再検査をお勧めします。

※2 0.85~0.99 Index の結果値の際には、適切な期間（例：2 週間）内に再採取し再検査をお勧めします。

▼従来法との比較（出典：SRL news No.2021-42）

### 【サイトメガロウイルス IgG】

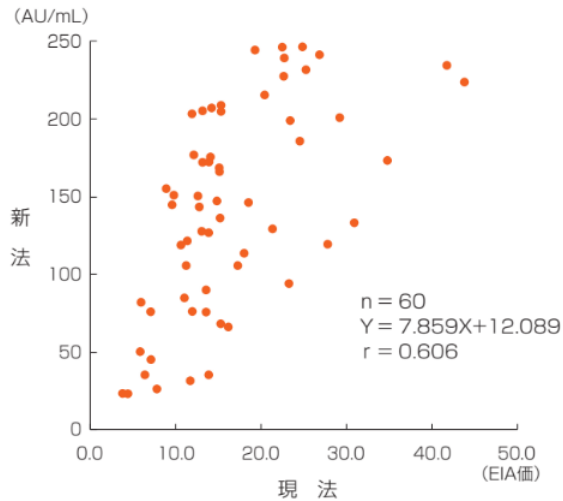


●相関一致表

		現 法		
		-	±	+
新 法	-	27	2	0
	±	0	0	0
	+	0	1	87

一致率：95.3% (N=117)

### 【サイトメガロウイルス IgM】

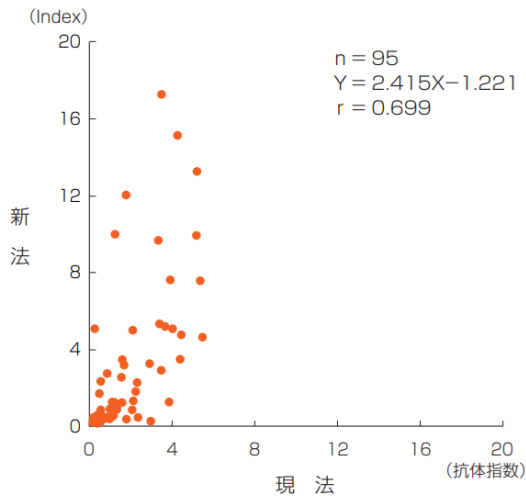

●相関一致表

		現 法		
		-	±	+
新 法	-	68	6	6
	±	0	1	1
	+	2	2	29

一致率：85.2% (N=115)

**変更日：2021年11月1日（月）受付分より**

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線7254）までお願い致します。