

2025年5月2日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室（生化学）

検査部回報 2025-No.16

改良試薬への変更のお知らせ

int-PTHの測定に使用している「エクルーシス試薬 PTH」が、改良試薬である「エクルーシス試薬 PTH v2」へ変更となります。改良試薬は、検査結果に影響を及ぼす可能性のある「血中ピオチン（ビタミンB7）」許容濃度の上限が拡大されています。また、試薬変更に伴い測定範囲が変更となります。（現行試薬：1.2 pg/mL～5000 pg/mL→改良試薬：2.4 pg/mL～5000 pg/mL）


現行試薬と改良試薬は良好な相関を示しており、ご依頼方法や結果報告値、基準範囲に変更はございません。

記

開始日： 2025 年 5 月 13 日（火）報告分より

変更項目：int-PTH

変更後の測定範囲：2.4 pg/mL～5000 pg/mL

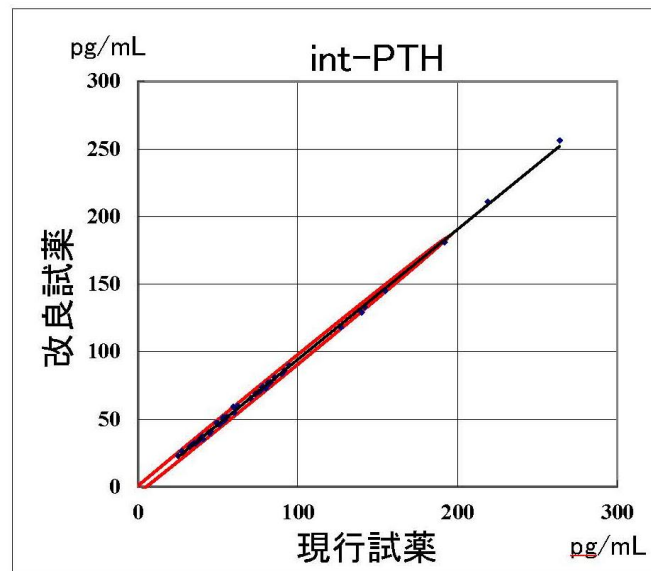

相関係数 $r =$	0.999
標準主軸回帰	$y = 0.96x - 2.04$

上記についてのお問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線7409）までお願い致します。